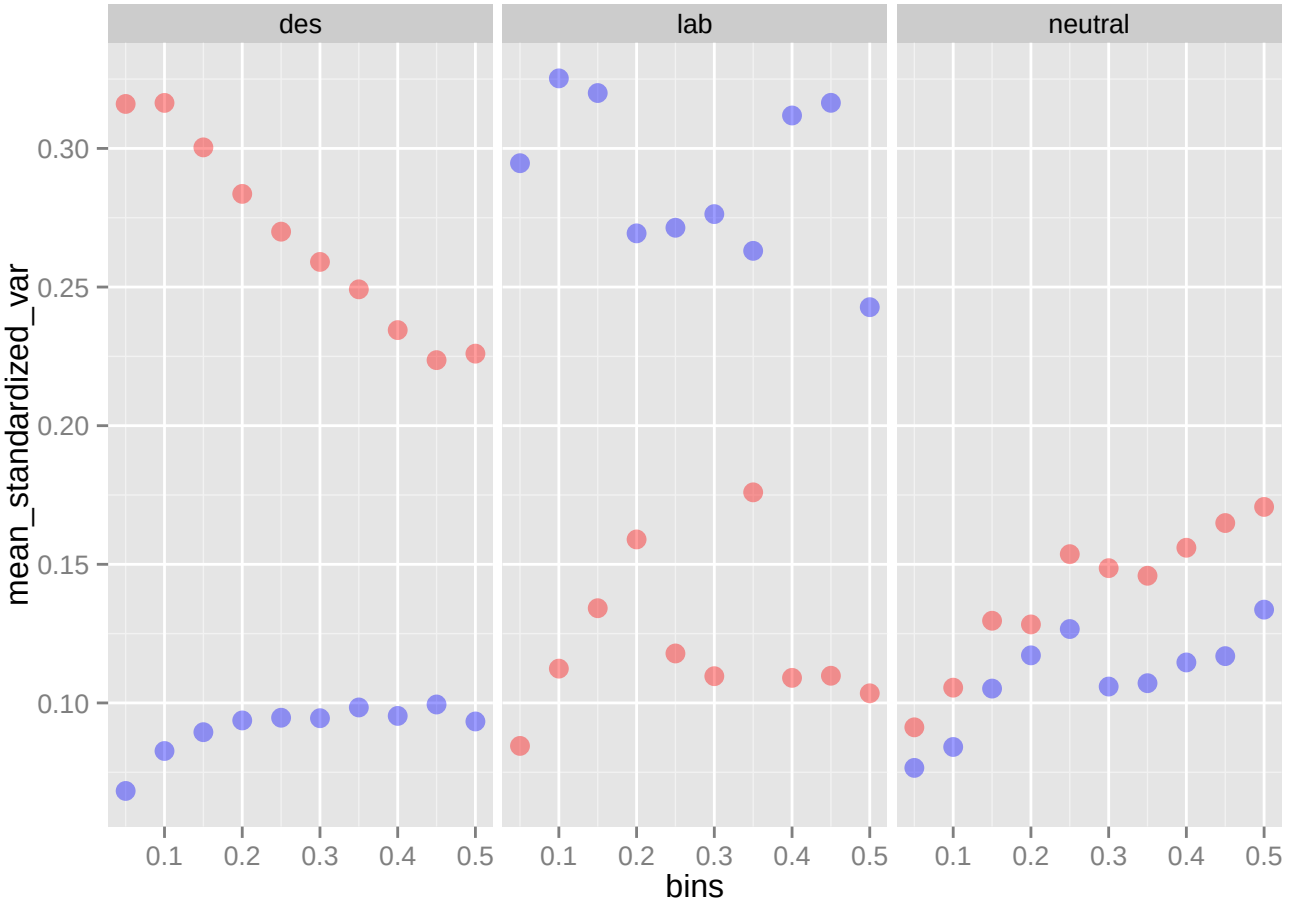
des
lab
neutral
mean_standardized_var
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
bins

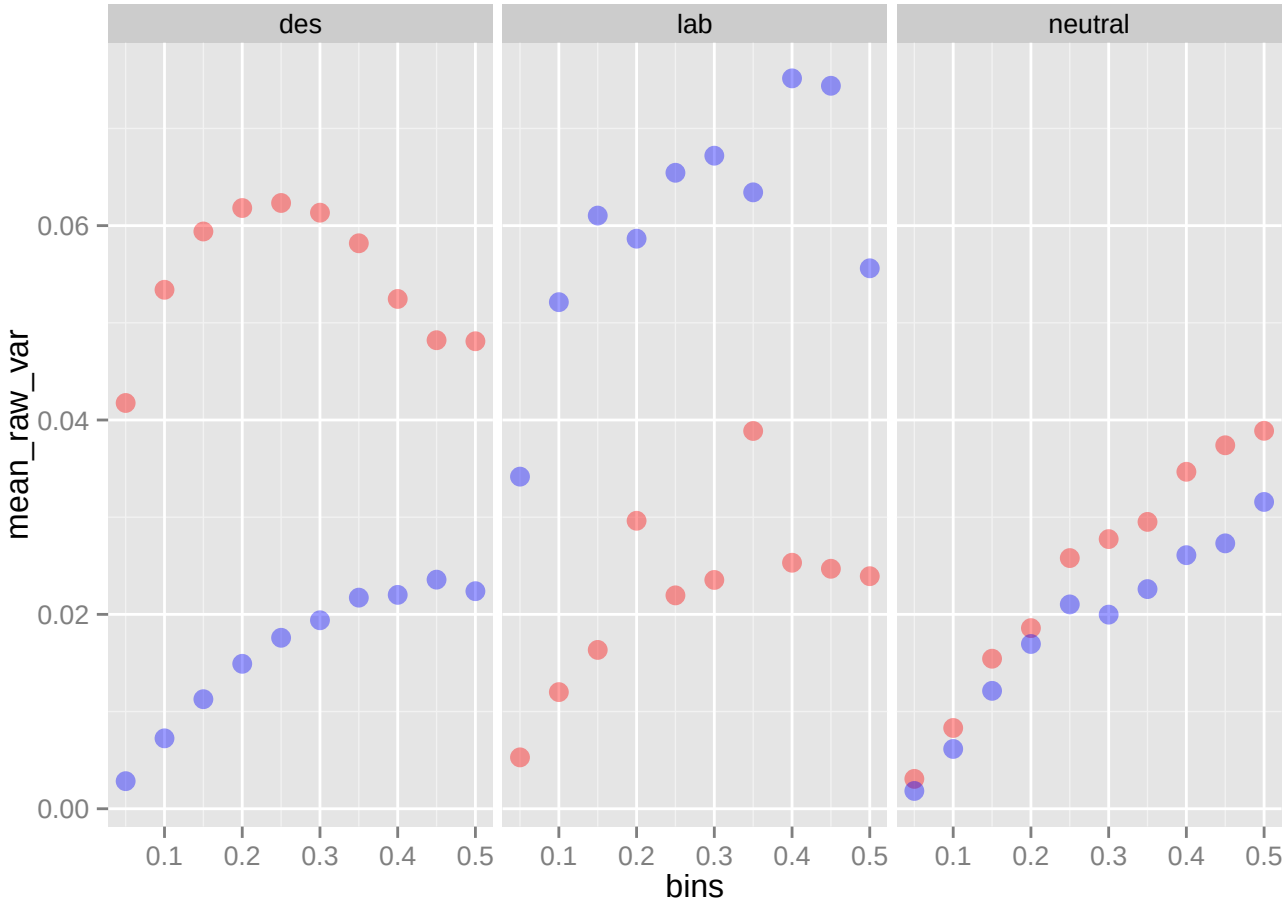
des
lab
neutral
mean_raw_var
0.00
0.02
0.04
0.06
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
bins

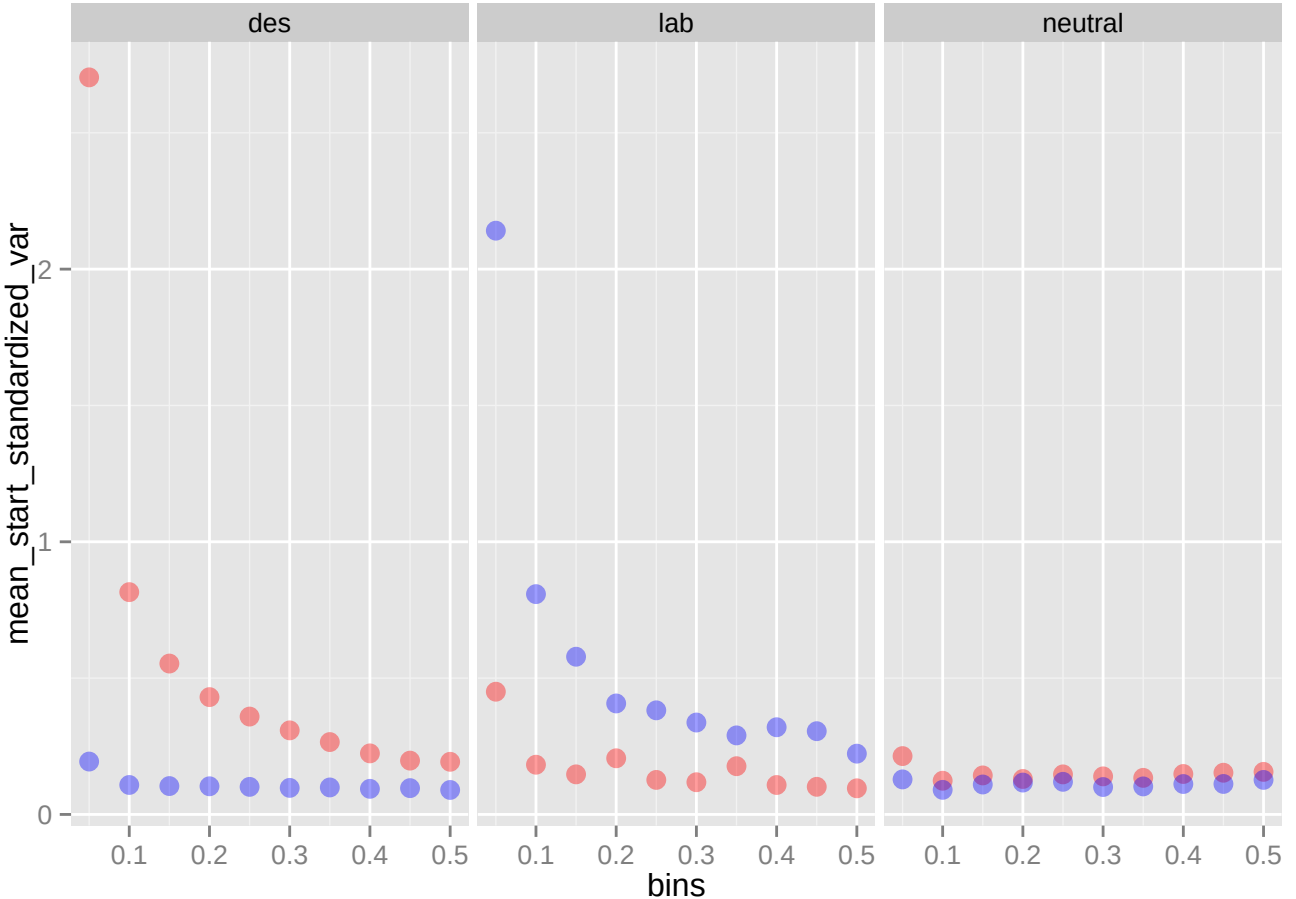
des
lab
neutral
mean_start_standardized_var
0
1
2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
bins